

FICHE DE MESURES

SURO PÉDIEUX



Membre inférieur **ORTHÈSES**

Société

Applicateur

Identification

Sexe Age Poids Taille

Date des mesures

Délai souhaité

Éléments fournis

- Fiche de mesures Fichier numérique
- Moulage avec fiche de mesures
- Photos profil/face avec fiche de mesures


Informations

- Releveur de pied Botte articulée
- Botte rigide Nocturne Diurne

Angulations pied

- Varus Valgus
- Flexion dorsale Flexion plantaire
- Après correction
-

Observations

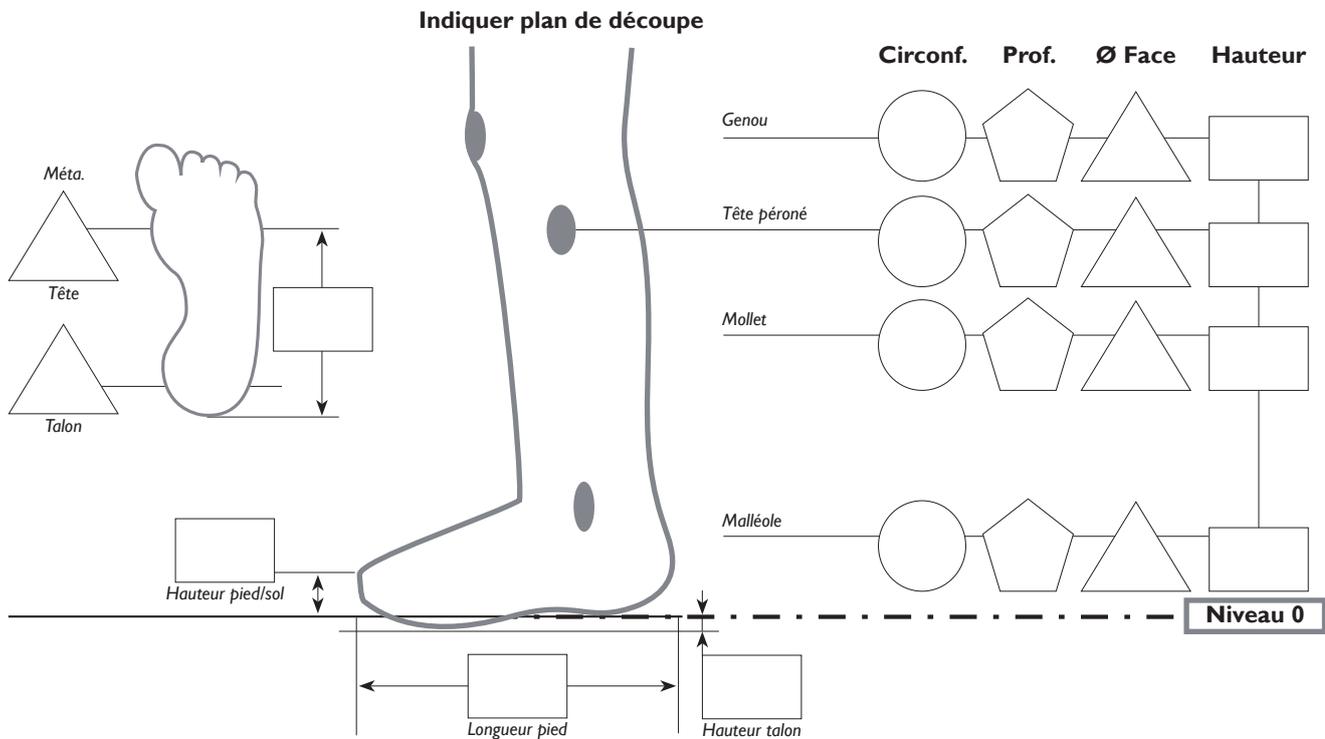

Cadre réservé à CSM

N° d'appareil

Opérateur

Réf. CSM production

WWW.GROUPE-G2M.COM



Demande de devis

Commande

Date

Société _____

Adresse de livraison _____

Applicateur

Contre marque

Délai souhaité

Observations _____

Éléments à fournir pour la modélisation

Moulage avec une fiche de mesures
OU
 Fiche de mesures
OU
 Photos profil/face avec une fiche de mesures
OU
 Fichier numérique STL (Stereolytographique)

Élément à fournir pour le fraisage

Fichier numérique Rodin 4D
OU
 Fichier numérique STL (Stereolytographique)
OU
 Photo Captevia (CPV)

Matière	Épaisseur
Polyéthylène HP	
Polypropylène	
Polypropylène copolymère	

Mousse capiton	Couleur	Épaisseur
Plastazote		
Tissu 3D		

Papier de transfert
Indiquer la référence souhaitée (reportez-vous à notre catalogue Fournitures ou demandez-nous notre document de choix de coloris)
Papier transfert fourni (cocher la case) <input type="checkbox"/>

Articulation
Cheville
Autre

Sangle velcro	Matière	Couleur
PVC		
PU		

Références	Descriptif	Cde
SBS100	Scanner moulage	
SBR100	Rectification botte	
SBU100	Fraisage botte maxi H. 64 cm	
SOIMP	Préparation d'un contre moule platré	

Composite		
SOI59CRL3	Releveur carbone lame JAD en 3 parties	
SOI59CRL	Releveur carbone lame JAD	
SOI59CAEL	Anti effondrement carbone lame JAD	
SOI59CAR	Botte carbone I articulation à rappel comprise	
SOI59LCC	Lame composite carbone sur mesure JAD	
SOI59C	Botte carbone	

Polyoléfine		
SOI59T	Botte releveur thermoformée	
SOIACS	Articulation de cheville souple sur une botte thermoformée	
SOI59ODAPI	Orthèse de Décharge Absolu du Pied	
SOI59ODAP2	Orthèse de Décharge Partielle du Pied	

FINITION ORTHÈSE		
SOI59G	Garniture tissu + velcro	

Cadre réservé à CSM

N° d'appareil

Opérateur

Date de livraison

Observations